


**Sprostowanie do raportu z eksperymentu pomiarowego
w ramach Pikniku Jakości Energii Elektrycznej**

18 czerwiec 2015

Niniejszym informujemy, że zawarte w Raporcie z eksperymentu pomiarowego (*Test 8i - Weryfikacja poprawności działania filtru antyaliasingowego*), wskazanie $THD_{L1}=0,58$ analizatora SO-52v11-eME zostało podane błędnie. Poprawnie odczytana wartość wynosi: $THD_{L1}=0,058 \approx 0,6$.

W związku z powyższym, zmianie względem opublikowanej wersji Raportu, ulega zawartość tabeli prezentujących wyniki testu 8 w zakresie wskazań THD_{L1} (górna tabela - strona 44), a także zmianie ulega wskazanie analizatora nr 8 z rysunku 2.24b) (strona 46).

Analizator		THD _{L1} [%]					Zgodność
		f)	g)	h)	i)	j)	
1	Fluke 1760	0,02	0,02	0,02	0,06	0,06	---
2	Nexus 1500	0,16	0,25	0,18	0,08	0,08	---
3	UP-2210	0,05	0,05	0,05	0,08	0,07	---
4	DEWE-3020	---	---	---	---	---	---
5	iSTAT M355	224,04	0,1	0,1	0,5	0,4	---
6	SO-52v11-eME	0,00	0,00	0,00	0,06	0,05	---
7	SIMEAS Q80	0,25	0,16	0,03	0,15	---	---
8	PQ Box 200	0,01	0,01	0,01	0,06	0,05	---
9	ION7650	---	---	---	---	---	---
10	PQM-703	0,00	0,00	0,00	0,06	0,05	---
11	PQube	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	---
12	G4500	0,02	0,02	0,03	5,03	4,96	---
13	MI 2892	1,68	15,13	3,73	0,51	14,36	---
14	Mavowatt 270	0,01	0,01	0,01	0,06	0,05	---

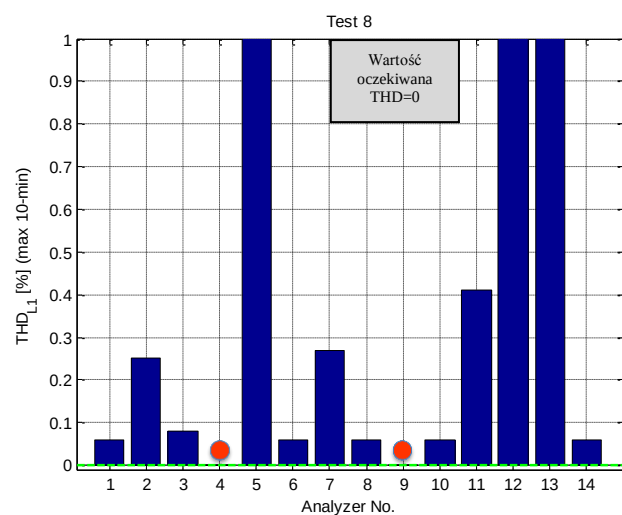

Rys. 2.24 b) a)-b) Porównanie maksymalnych wskazań (10-min) Pst L1 oraz THDL1 - Test 8